



ประกาศหวัดบุรีรัมย์
ที่ ๓๐ /๒๕๖๗
เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะขายโดยวิธีทอดตลาด ด้วยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์
ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไปจริง ของโรงพยาบาลคูเมือง จึงกำหนด
เงื่อนไขรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการที่จะขายโดยวิธีทอดตลาด ได้แก่ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๗ รายการ
๒. ผู้ประสงค์ขอซื้อติดต่อขอเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลคูเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ซื้อเข้าเสนอราคาที่งานพัสดุ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ในวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
๓. การขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อทอดตลาด โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงให้
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และผู้เสนอราคาจะถอนราคาของตนที่เสนอได้นั้นมิได้ เมื่อผู้ทอดตลาดยังมีได้ตกลง
และผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาของตนต่อเมื่อผู้อื่นเสนอราคาสูงกว่า
๔. ผู้เสนอราคาสูงสุดที่ผู้ทอดตลาดได้ตกลงให้เป็นผู้ซื้อต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่
โรงพยาบาลคูเมืองทันที และเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ขนครุภัณฑ์ดังกล่าวเองและต้องขนย้าย ให้แล้ว
เสร็จ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันซื้อขายและหากผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ชำระเงิน ผู้ทอดตลาดจะเอา
ทรัพย์สินออกขายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
๕. คณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้ทอดตลาด ทรงไว้ซึ่งสิทธิเมื่อเห็นว่าราคาสูงสุดยังไม่
เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติ โล่สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

โรงพยาบาลคูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
1	งานรับส่งสัญญาณ ห้อยที่ ทุ ห้อยที่		5865-401-0001-6	1	5,800.00	เงินบำรุง	2,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
2	งานรับส่งสัญญาณ ห้อยที่ ทุ ห้อยที่		5865-401-0001-2	1	5,800.00	เงินบำรุง	2,000.00	รพ.สต.ประเคียบ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
3	งานรับส่งสัญญาณ ห้อยที่ ทุ ห้อยที่		5865-401-0001-2	1	5,800.00	เงินบำรุง	2,000.00	รพ.สต.โคกกล่อง	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
4	เครื่องพ่นยา PULMo-MIS		6515-003-4402-11	1	3,500.00	เงินบำรุง	20.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
5	เครื่องพ่นยา PULMo-MIS		6515-003-4402-1	1	3,500.00	เงินบำรุง	20.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
6	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า		6515-035-0100-8	1	บริจาค	บริจาค	100.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
7	เครื่องดูดเสมหะ		6515-037-0101-20	1	23,000.00	เงินบำรุง	200.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
8	เครื่องควบคุมการให้สารละลาย เข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ		6515-035-0100-3	1	บริจาค	บริจาค	50.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
9	เครื่องพ่นยา		6515-003-4420-23	1	3,500.00	เงินบำรุง	20.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

โรงพยาบาลคูเมืองประจำกิ่งบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่เคยค่า จะจำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
10	เครื่องปั่นตะกอน		6515-006-0002-2		42,000.00	งปม.	500.00	แลกเปลี่ยน	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
11	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม		6515-069-1201-51		7,000.00	บำรุง	100.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
12	เครื่องพ่นยา		6515-003-4402-40		8,500.00	บำรุง	100.00	ตึกเด็ก	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
13	เครื่องวัดความดัน		6515-069-1201-27		2,000.00	บำรุง	100.00	ตึกเด็ก	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
14	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด อัตโนมัติ		6515-035-0100-9		5,700.00	งบลงทุน	100.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
15	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม		6515-069-1201-99		8,000.00	บำรุง	50.00	LR	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
16	เครื่องวัดความดันโลหิต		6515-069-1201-54		8,000.00	งบค่าเสื่อม	50.00	IMC	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
17	เครื่องวัดความดันโลหิต		6515-069-1201-49		2,000.00	บำรุง	50.00	LR	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
18	เครื่องอัลตราซาวด์ยี่ห้อ Medison 128 BW		6525-008-3101-2		528,490.00		150.00	LR	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
โรงพยาบาลคูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
19	เครื่องวัดความดันแบบมีล้อ		6515-069-1201-7		2,000.00	บำรุง	50.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
20	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบผู้ใหญ่		6515-069-1201-20		2,000.00	บำรุง	20.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
21	เก้าอี้จัดเลี้ยง		3110-006-0024-186		550.00	งานวิจัย	20.00	ตึก114/4	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
22	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-160		1,200.00	เงินบำรุง	20.00	ยุทธศาสตร์	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
23	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-223		2,200.00	เงินบำรุง	20.00	NCD	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
24	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-66		4,560.00	เงินบำรุง	20.00	ห้อง ผอ.	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
25	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-65		4,560.00	เงินบำรุง	20.00	บริหาร	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
26	ผู้เขียน		4140-001-0001-7		1,720.00	เงินบำรุง	500.00	ผลิต	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
27	รถเข็นจ่ายยา		3920-005-1434-20		60,000.00	เงินบำรุง	50.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
28	รถฉีดยาสแตนเลส		3920-005-1103-2		3,500.00	เงินบำรุง	50.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
โรงพยาบาลคูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
29	ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร		7102-902-0001-1		5,900.00	เงินบำรุง	20.00	โรงครัว	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
30	พัดลม		4140-001-0004-240		2,300.00	เงินบำรุง	50.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
31	พัดลมอุตสาหกรรม		4140-001-0001-5		1,250.00	เงินบำรุง	50.00	OPD	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
32	พัดลมตั้งพื้น		4140-001-0001-139		420.00	เงินบำรุง	20.00	โควิท	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
33	พัดลมติดผนัง		4140-001-0004-273		1,690.00	เงินบำรุง	50.00	IMC	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
34	พัดลมตั้งพื้น		4140-001-0001-114		บริจาค	บริจาค	20.00	ตึกขาย	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
35	ตู้แช่		4110-007-0001-5		15,900.00	เงินบำรุง	500.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
36	ปริ้นเตอร์ HP		7440-012-0001-87		บริจาค	บริจาค	100.00	บริหาร	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
37	โทรศัพท์ Panasonic		5805-001-0004-27		2,990.00	เงินบำรุง	20.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
โรงพยาบาลคูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่สามารถ จะจำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
38	เครื่องตรวจตา คอ หู จมูก		6515-033-0301-1		14,000.00	เงินบำรุง	50.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
39	Acer Aspire M1641		7440-001-0006-66		3,700.00	เงินบำรุง	20.00	ER	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
40	รถเข็นสแตนด์เลส		3920-005-9202-1		4,500.00	เงินบำรุง	100.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
41	รถเข็นผู้ป่วยสแตนด์เลส		3920-005-1101-1		3,500.00	เงินบำรุง	100.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
42	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง		3920-005-1104-36		6,900.00	เงินบำรุง	20.00	กลุ่มการ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
43	โต๊ะอนกประสงค์		7110-007-0007-15		2,090.00	เงินบำรุง	10.00	ห้องประชุม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
44	โต๊ะอนกประสงค์		7110-007-0007-1		2,090.00	เงินบำรุง	10.00	ห้องประชุม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
45	โต๊ะอนกประสงค์		7110-007-0007-2		2,090.00	เงินบำรุง	10.00	ห้องประชุม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
46	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งพับได้		3920-005-1104-38		6,900.00	กองทุนIMC	10.00	กายภาพ	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
47	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-65		4,650.00	เงินบำรุง	20.00	บริหาร	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้


เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
โรงพยาบาลคูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ (ขนาด / ลักษณะ)	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย	แหล่ง งบประมาณ	ราคาที่สามารถ จะจำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่าย	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล จำหน่ายแต่ละรายการ
48	เก้าอี้ผู้บริหาร		7110-006-0007-66		4,650.00	เงินบำรุง	20.00	บริหาร	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
49	โคมไฟสนาม		6230-005-0002-2		1,723.00	เงินบำรุง	50.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
50	เก้าอี้สนามพร้อมอ่างบัวนปาก		6520-013-0001-1		2,780.00	เงินบำรุง	100.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
51	เครื่องพ่นอนุภาคชาร์ป		4130-002-0001-9		4,000.00	เงินบำรุง	100.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
52	เครื่องฉายแสง		6520-009-0001-7		บริจาค	บริจาค	20.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
53	เครื่องฉายแสง		6520-009-0001-6		44,000.00	งปม.	20.00	ทันตกรรม	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
54	เก้าอี้สำนักงาน		7110-006-0007-122		2,500.00	บำรุง	20.00	X-ray	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
55	เครื่องซักผ้า		3510-012-001-5		200,000.00	งบประมาณ	2,000.00	ชีพหลาย	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้
56	โคมไฟผ่าตัด		6530-005-2116-1		250,000.00	งบประมาณ	3,000.00	oR	ขาย	ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้

ลำดับที่ ๑

งานรับสัญญาณ พ้อยทูพ้อย รพ.คูเมือง


หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๖๕-๔๐๑-๐๐๐๑-๖

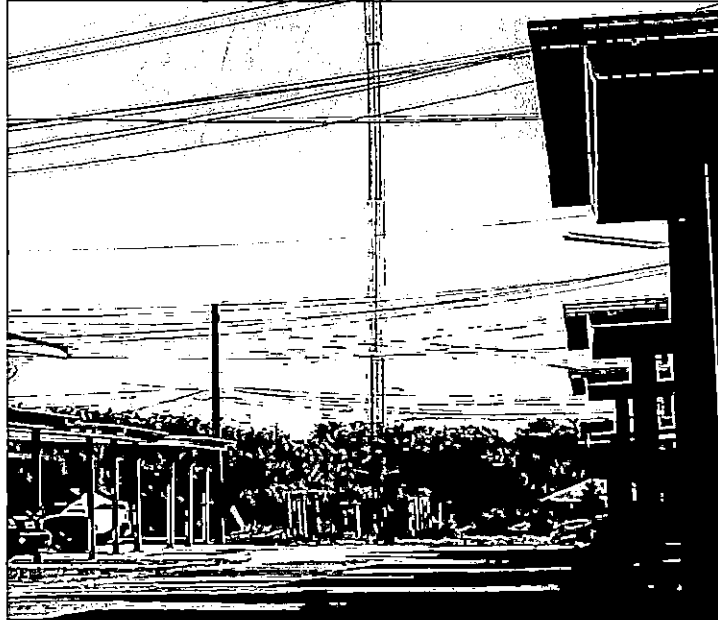

ลำดับที่ ๒

เสารับสัญญาณพ้อยทูพ้อย รพ.ปะเคียบ

หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๖๕-๔๐๑-๐๐๐๑-๒

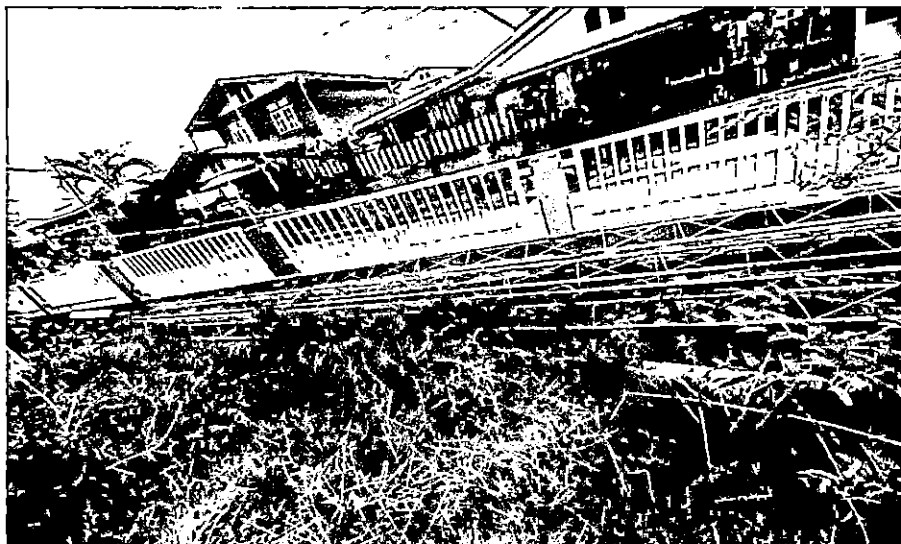

ลำดับที่ ๓

เสารับสัญญาณพ้อยทูพ้อย ทรพสต.โคกก่อ

หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๖๕-๔๐๑-๐๐๐๑-๓



ลำดับที่ ๔

เครื่องพ่นยา PULMo-MIS

หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๒-๑๑



ลำดับที่ ๕

เครื่องพ่นยา PULMo-MIS


หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๒-๑



ลำดับที่ ๖

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า


หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๕-๐๑๐๐-๘

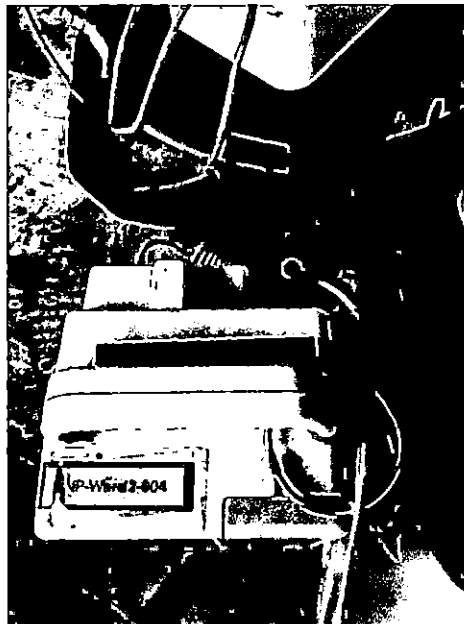

ลำดับที่ ๗

เครื่องดูดเสมหะ

หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๑๐๑-๒๐

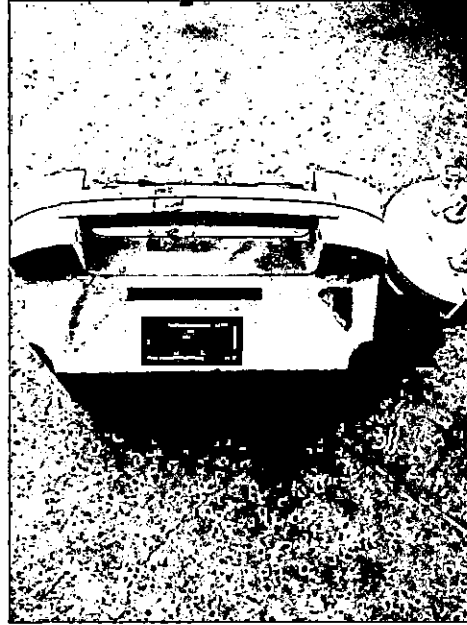

ลำดับที่ ๘

เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ


หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๕-๐๑๐๐-๓



ลำดับที่ ๙

ไม่มีข้อมูล


๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๒๐-๒๓

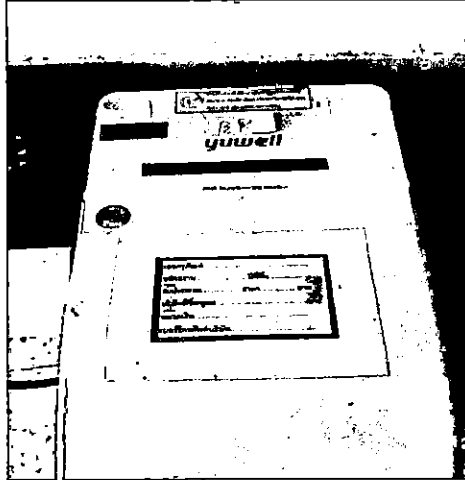

ลำดับที่ ๑๐

เครื่อง ไม้แกะกอน


๖๕๑๕ - ๐๐๖ - ๐๐๗๘ - ๒๘

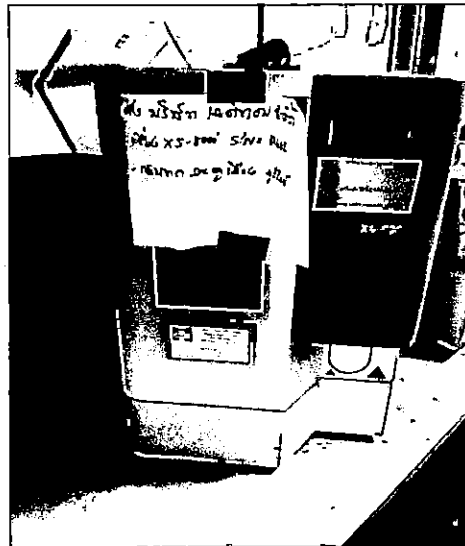

ลำดับที่ ๑๑

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม


๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑-๕๑

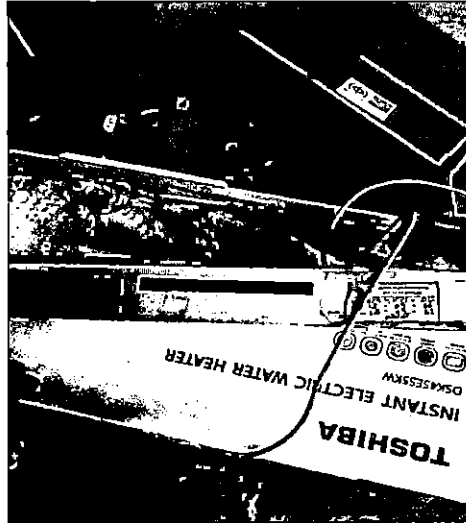

ลำดับที่ ๑๒

เครื่องพ่นยา

๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๒-๔๐

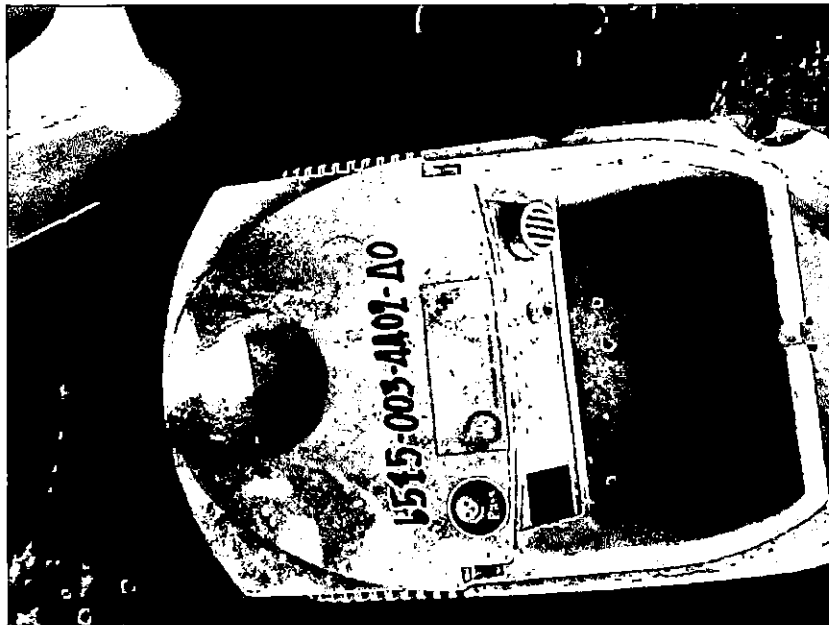

ลำดับที่ ๑๓

เครื่องวัดความดันแบบ


ไม่มีเลขครุภัณฑ์



ลำดับที่ ๑๔

เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump)

๖๕๑๕-๐๓๕-๐๑๐๐-๙

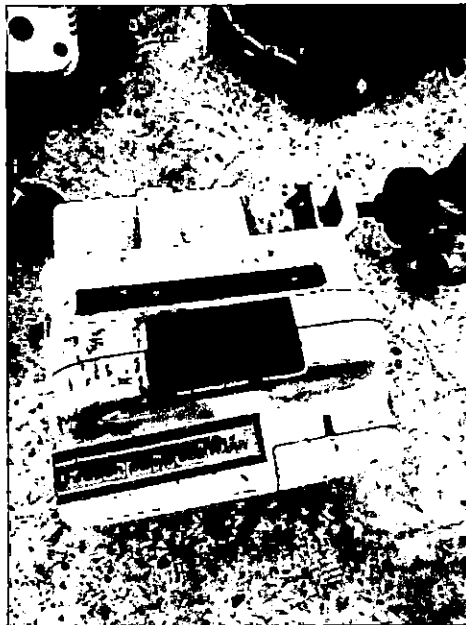

ลำดับที่ ๑๕

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเซ็นเซอร์ รุ่น LCD

๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑-๙๙



ลำดับที่ ๑๖

เครื่องวัดอุณหภูมิ


๖๕๑๕-๐๖๙-๐๒๐๑-๙๙



ลำดับที่ ๑๗ เครื่องวัดอุณหภูมิ
รุ่น ๖๕ - ๐๖๘ - ๑๕๐๑ - ๕๕๗



ลำดับที่ ๑๘
เครื่องวัดอุณหภูมิ
รุ่น ๖๕ - ๐๐๘ - ๓๑๐๑ - ๒

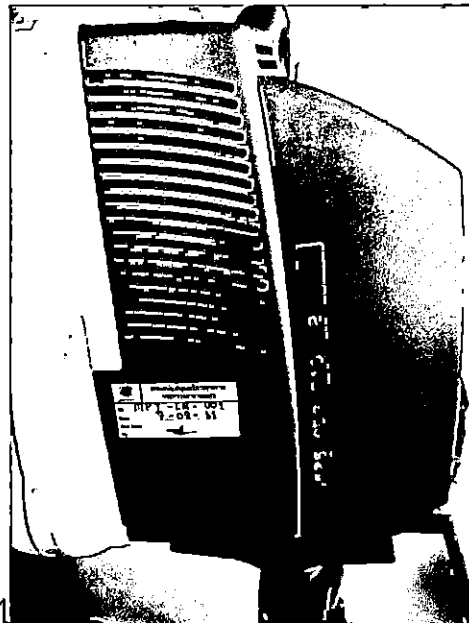

ลำดับที่ ๑๙

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ ยี่ห้อ MaC Sphygmomanometer


๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑-๗



ลำดับที่ ๒๐

เครื่องวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่

๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑-๒๐

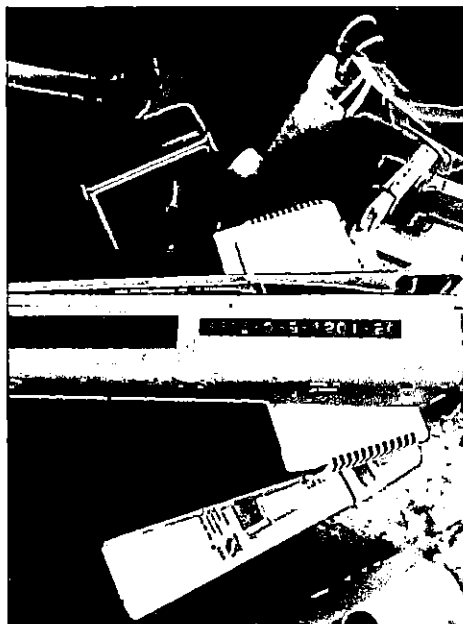

ลำดับที่ ๒๑

เก้าอี้จัดเลี้ยง

๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๔-๑๘๖



ลำดับที่ ๒๒

เก้าอี้สำนักงาน

๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๗-๑๖๐



ลำดับที่ ๒๓

เก้าอี้สำนักงาน ขาขุมมีล้อเลื่อน

๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๗-๒๒๓



ลำดับที่ ๒๔

เก้าอี้สำนักงาน PVC

๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๗-๖๖



ลำดับที่ ๒๕

เก้าอี้สำนักงาน


๙๑๑๐ - ๑๐๖ - ๐๕๐๗ - ๖๕



ลำดับที่ ๒๖

ตู้เย็น


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๗

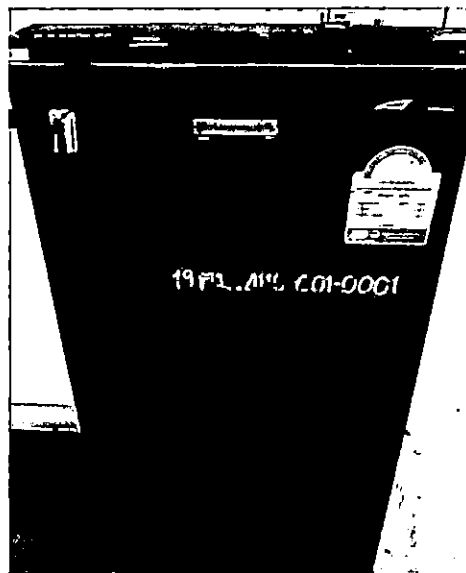

ลำดับที่ ๒๗

รถเข็นจ่ายยา

๓๙๒๐-๐๐๕-๑๔๓๕-๒๐

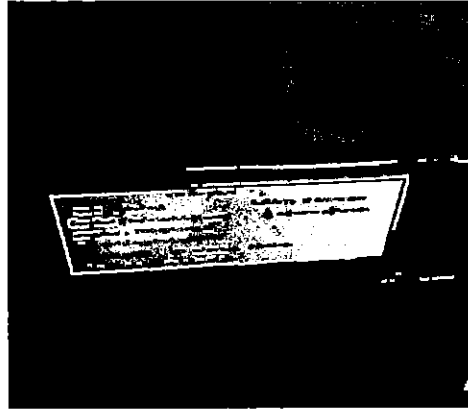

ลำดับที่ ๒๘

รถฉีดยาเสตนเลส


๓๙๒๐-๐๐๕-๑๑๐๓-๒



ลำดับที่ ๒๙

ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

๗๑๙๕-๙๐๒-๐๐๐๑-๑

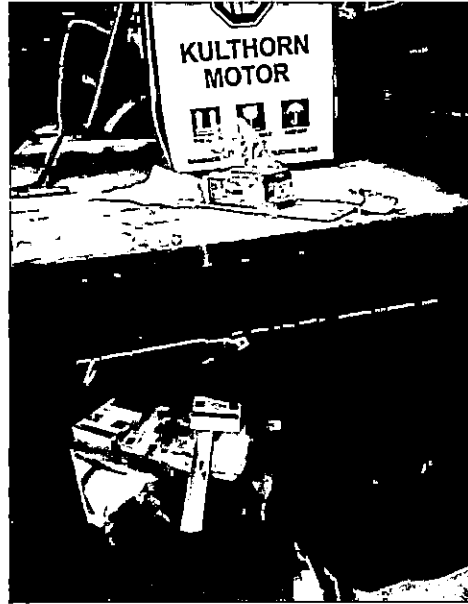

ลำดับที่ ๓๐

พัดลม


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔-๒๔๐



ลำดับที่ ๓๑

พัฒนาอุตสาหกรรม


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕*

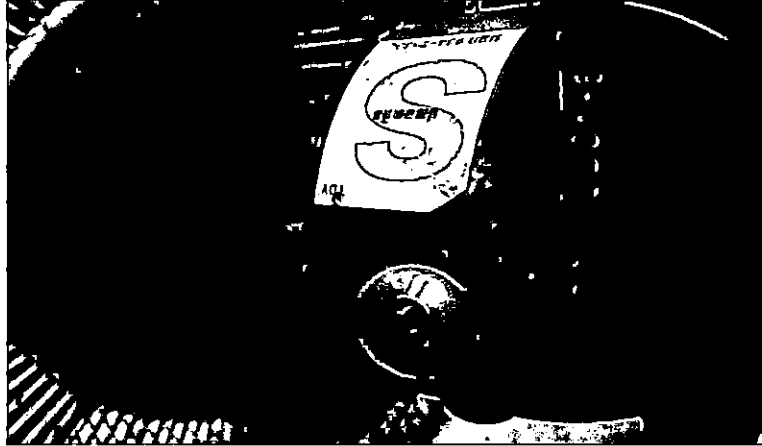

ลำดับที่ ๓๒

พัฒนาตั้งพื้นที่ ๓ ใบพัด


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๙

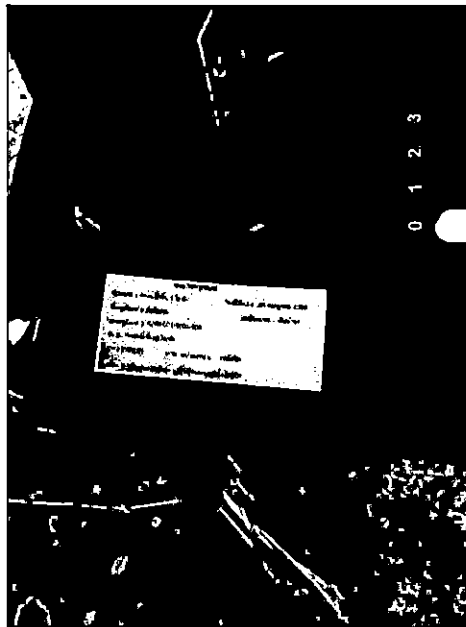

ลำดับที่ ๓๓

พัดลมติดผนัง MITSUBISHI W๑๖-GV


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔-๒๗๓

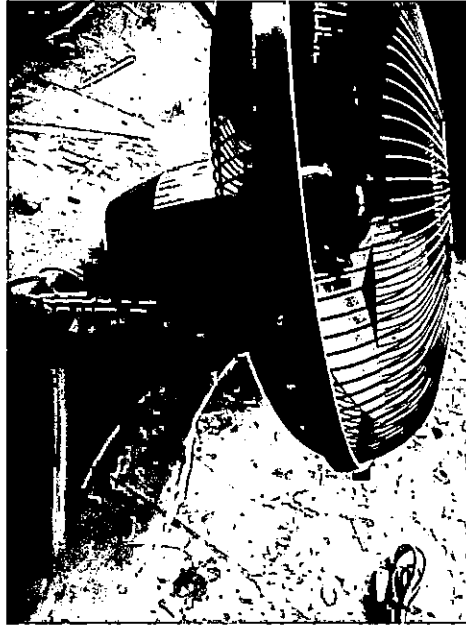

ลำดับที่ ๓๔

พัดลมตั้งพื้น


๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๑๔

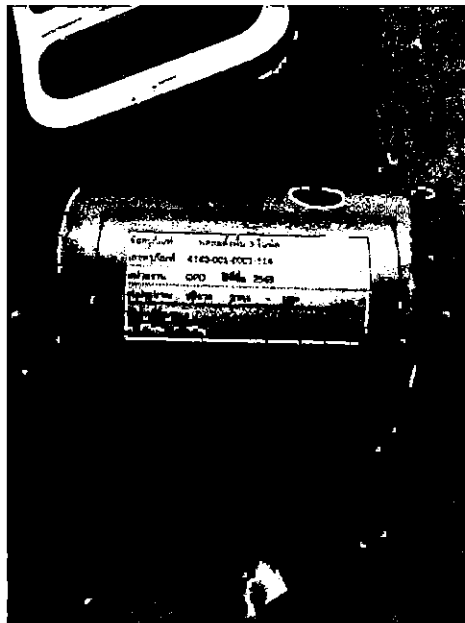

ลำดับที่ ๓๕

ตู้แช่ ทรงตู้เย็น MIRAGE BC๒๔๙F


๔๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๕

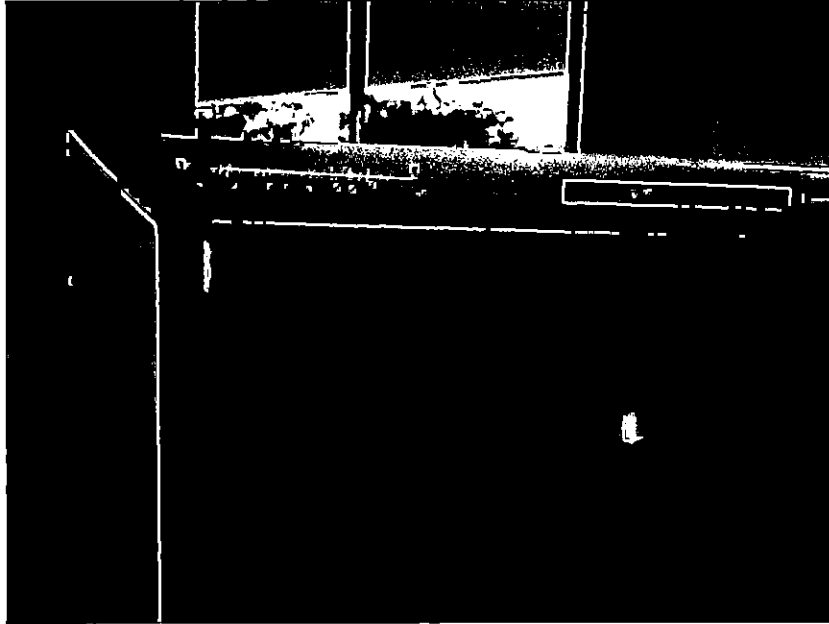

ลำดับที่ ๓๖

ปริ้นเตอร์ HP MFP M๑๓๐fW

๗๔๔๐-๐๑๒-๐๐๐๑-๘๗

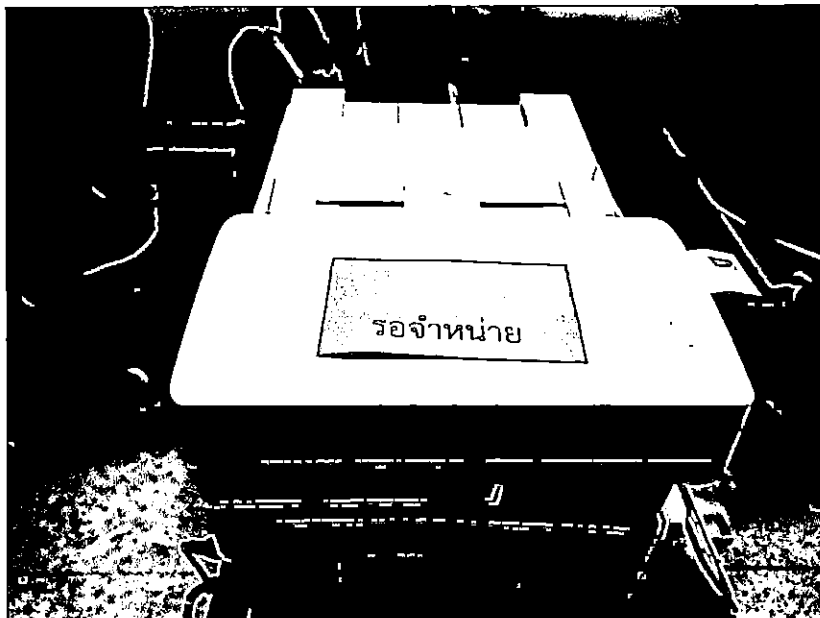

ลำดับที่ ๓๗

KX-TG๓๗๑๒BX ยี่ห้อ Panasonic


๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๔-๒๗



ลำดับที่ ๓๘

เครื่องตรวจตา คอ หู จมูก


๖๕๑๕-๐๓๓-๐๓๐๑-๑

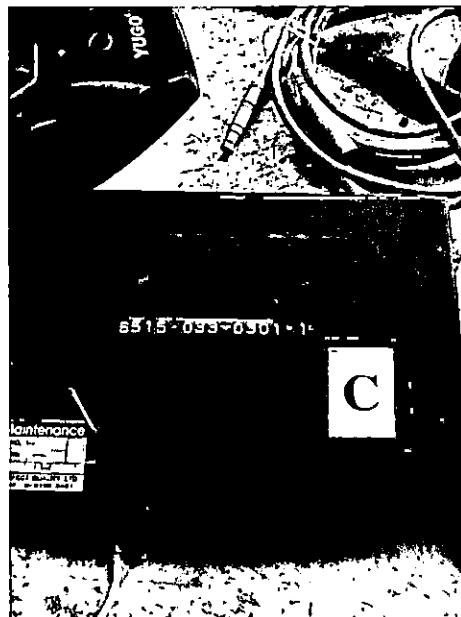

ลำดับที่ ๓๙

Acer Aspire M๑๖๔๑


๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖-๖๖

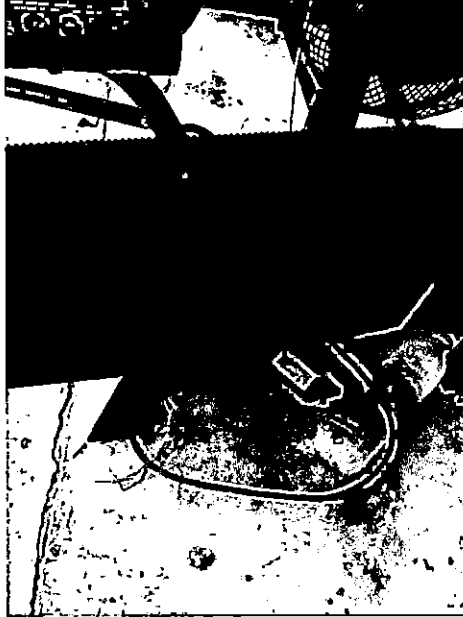

ลำดับที่ ๔๐

รถเข็นสแตนเลส


๓๙๒๐-๐๐๕-๙๒๐๒-๑

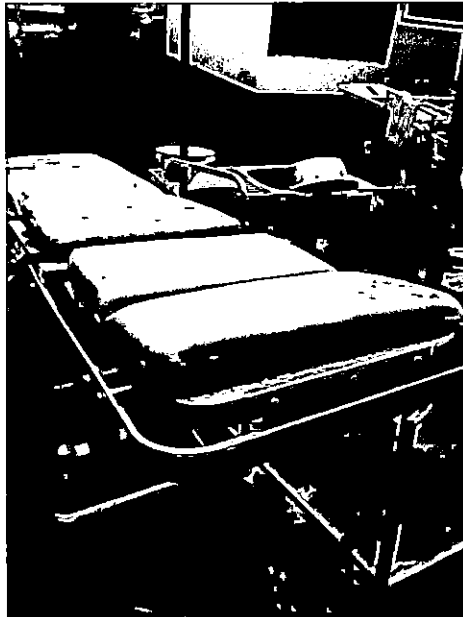

ลำดับที่ ๔๑

รถเข็นผู้ป่วยสแตนเลส


๓๙๒๐-๐๐๕-๑๑๐๑-๑

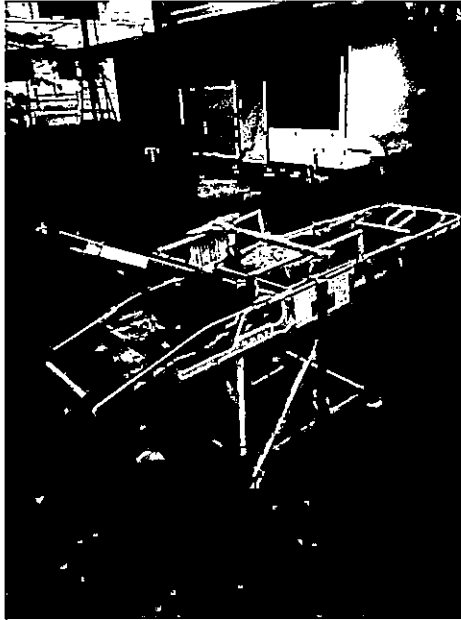

ลำดับที่ ๔๒

รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง

๓๙๒๐-๐๐๕-๑๑๐๔-๓๖

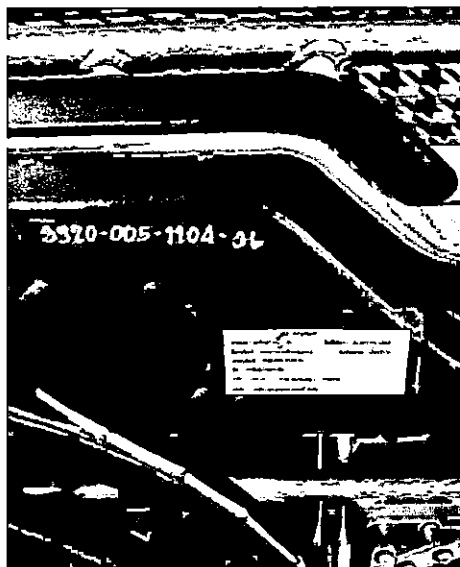

ลำดับที่ ๔๓



ลำดับที่ ๔๔




ลำดับที่ ๔๕



ลำดับที่ ๔๖

รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งพับได้

๓๙๒๐-๐๐๕-๑๑๐๔-๓๘

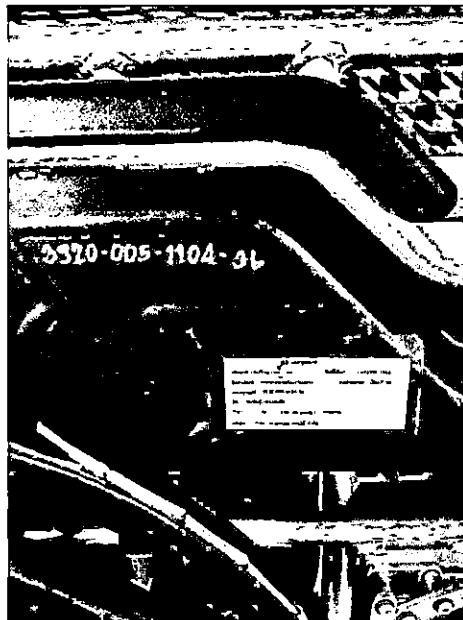

ลำดับที่ ๔๗

เก้าอี้สำนักงาน

๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๗-๖๕



ลำดับที่ ๔๘


เก้าอี้ผู้บริหาร



ลำดับที่ ๔๙

คอมไฟสนาม


๖๒๓๐-๐๐๕-๐๐๐๒-๒

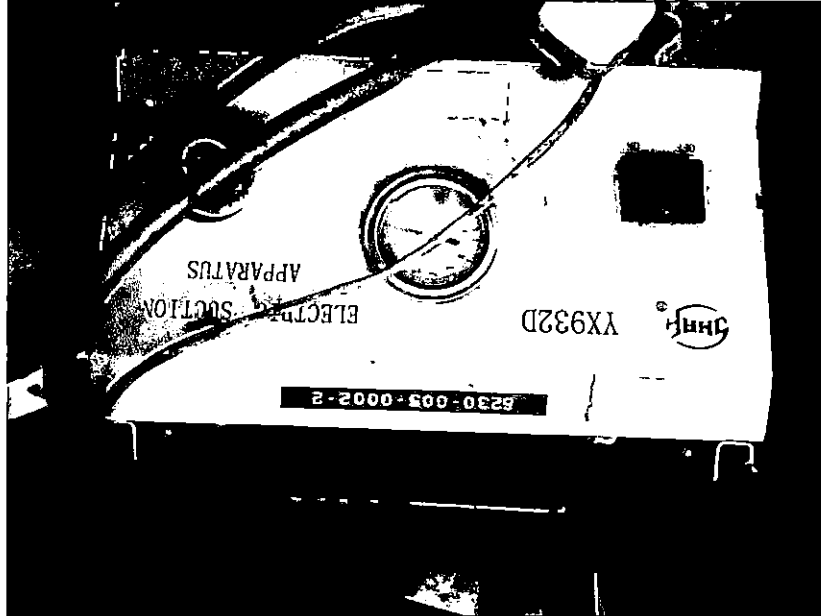

ลำดับที่ ๕๐

เก้าอี้สนามพร้อมอ่างบัวนปาก


๖๕๒๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๑

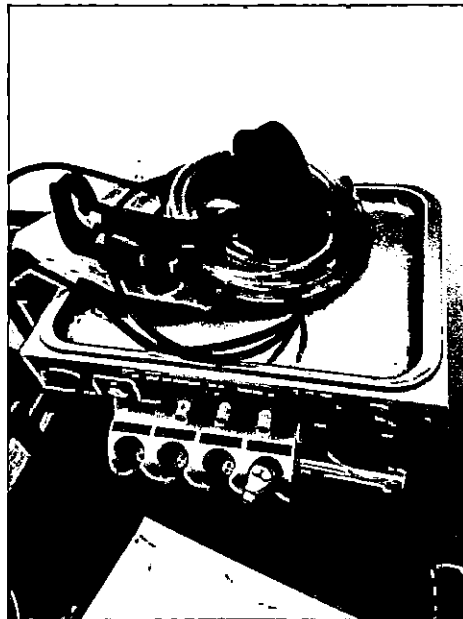

ลำดับที่ ๕๑

เครื่องพ่นอนุภาคซาร์ป


๔๑๓๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๙

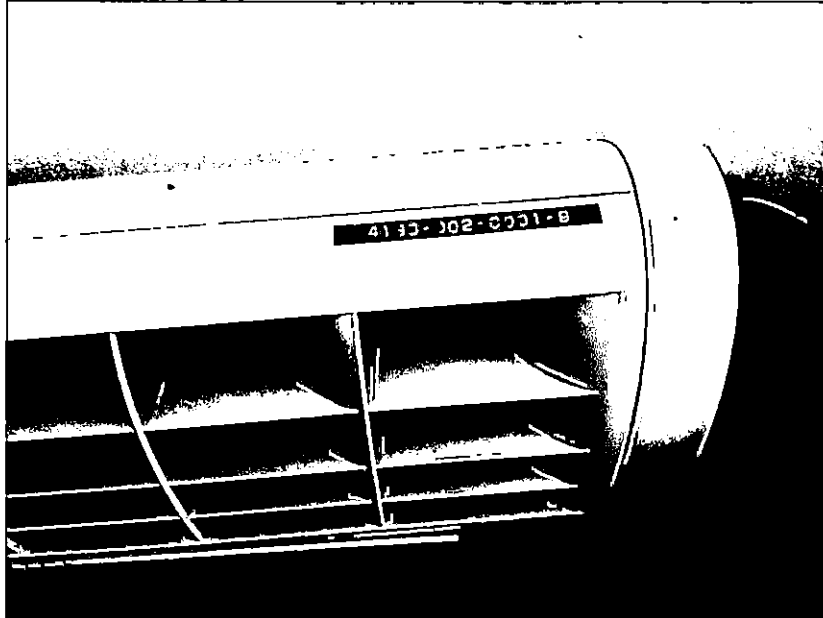

ลำดับที่ ๕๒

เครื่องฉายแสง

๖๕๒๐-๐๐๙-๐๐๐๑-๗

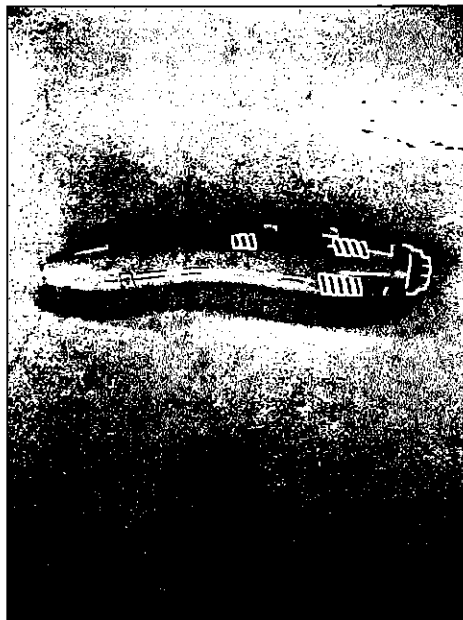

ลำดับที่ ๕๓


เครื่องฉายแสง

๖๕๒๐-๐๐๙-๐๐๐๑-๖



ลำดับที่ ๕๔

เก้าอี้สำนักงาน

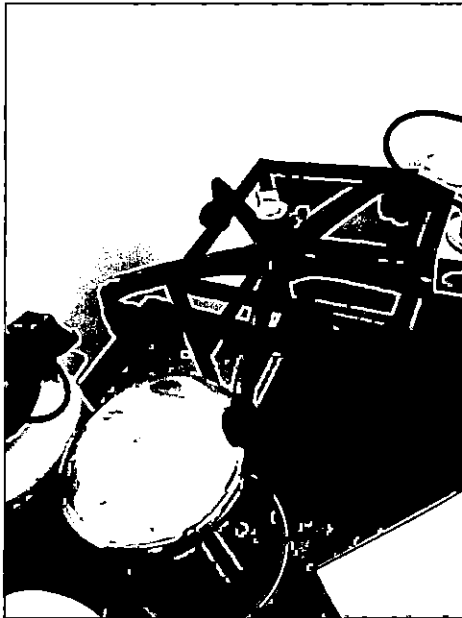


ลำดับที่ ๕๕

เครื่องซักผ้า




ลำดับที่ ๕๖

คอมไฟผ้าตัด

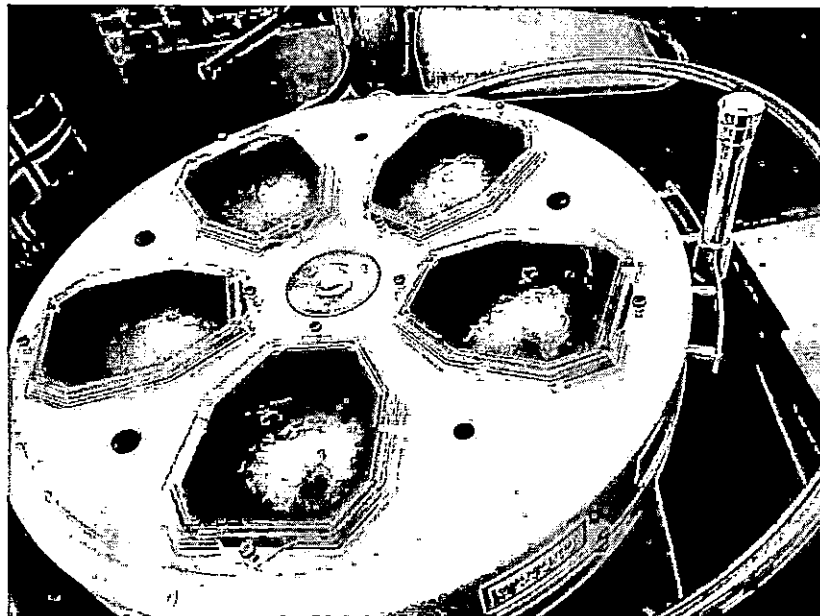

ลำดับที่ ๕๗

เครื่องเอ็กซ์เรย์

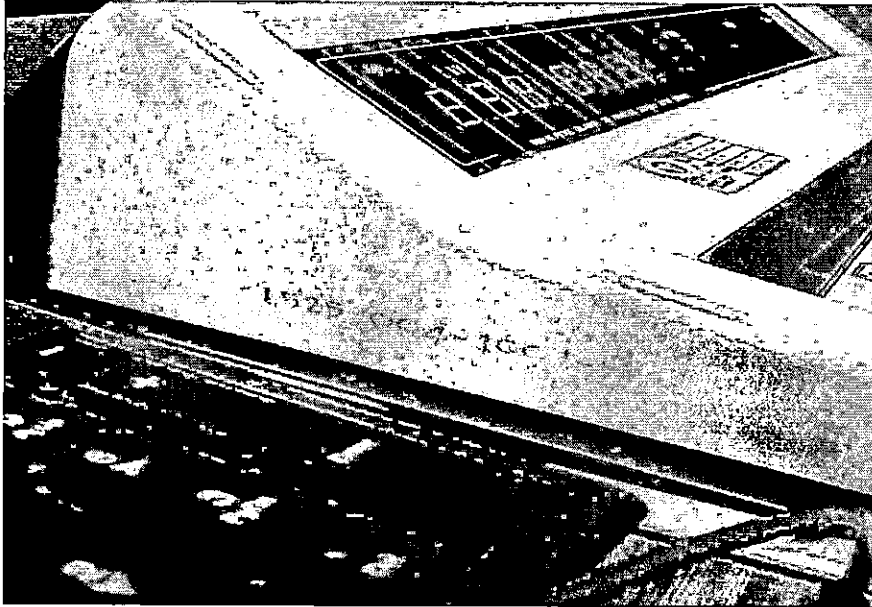

ใบเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด

บริษัท / ห้างฯ / ร้าน

ตั้งอยู่เลขที่ ถนน

อำเภอ จังหวัด

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง(ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)

บริษัท / ห้างฯ / ร้าน ขอเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาประเมิน ขั้นต่ำ		ราคาที่เสนอ		หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลคูเมือง	57 รายการ	24,390	-			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....)

กำหนดยื่นราคา วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

กำหนดส่งของ วัน นับจากวันทำสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง